

日本薬局方 注射用水

大塚蒸留水(100mL・500mLプラボトル:ゴム栓タイプ)

容器ラベルの表示変更のご案内


このたび、標記製品の容器ラベルの注意表示を変更しましたので、ご案内申し上げます。

変更内容


■ 容器ラベルの注意表示変更

注射用水は浸透圧が 0 mOsm/L のため、誤って単独で点滴しないようゴム栓タイプの注射用水のラベルには「本剤を単独で点滴しないでください。」と表示しておりましたが、注意喚起がより目立つように赤地に白文字で「単独点滴禁止」の表示に変更しました。

・ 100mL プラボトル

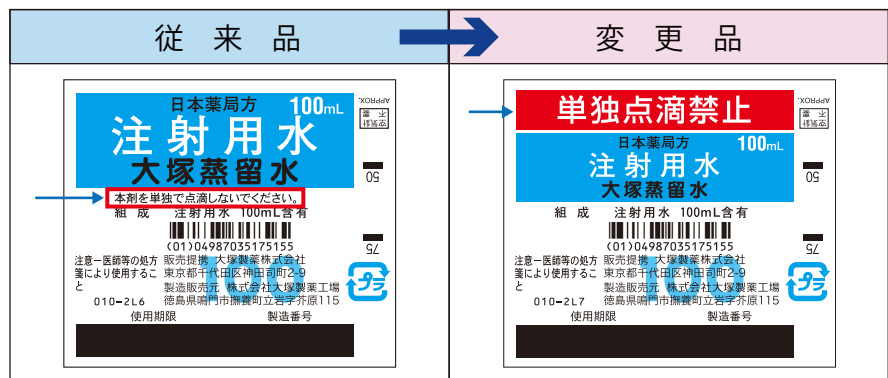

・ 500mL プラボトル

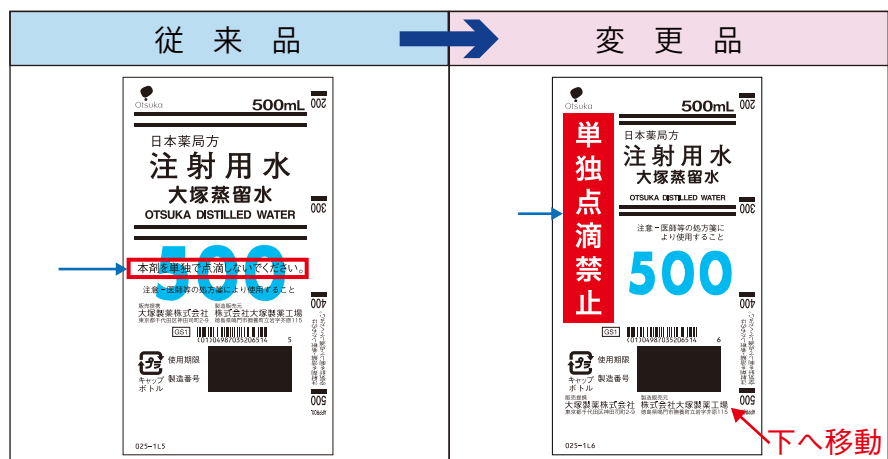

■ 変更品の出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期
大塚蒸留水	100mL×10本	035-17511-7	2019年5月中旬
	500mL×20本	035-13280-6	2019年4月上旬

変更した製品の10本ケース及び梱包ケースには、当分の間、**表示変更品** を表示いたします。
製品流通の面から、変更品がお手元に届く時期が出荷予定時期と異なることもございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元

株式会社大塚製薬工場